

技术参数论证会专家签到表

项目名称：洛阳市妇幼保健院辅助生殖、儿童保健专项能力提升项目及危重新生儿诊断救治能力提升项目第五批

采购单位：洛阳市妇幼保健院

专家人数：5 人（技术 4 人，法律 1 人）

日期：2025 年 11 月 21 日

序号	单位名称	姓名	职称	联系电话	专家类别
1	洛阳职业技术学院	张永刚	教授	13937907104	技术
2	洛阳市疾控中心	王宇川	副主任医师	13592090026	技术
3	洛阳市消防支队	曹书琴	副主任医师	1363889506	技术
4	河南科技大学	连建学	副主任医师	15978622329	技术
5	洛阳市市场监督管理局	王小花	律师	13937958660	法律
6					

政府采购产品技术参数专家论证意见表

专家姓名	王小庄
工作单位	洛阳市市场监督管理局
采购单位名称	洛阳市妇幼保健院
项目名称	洛阳市妇幼保健院辅助生殖、儿童保健专项能力提升项目及危重新生儿诊断救治能力提升项目第五批
产品名称	一体化阅片中心系统、电子阴道镜、染色体全自动扫描及分析系统、锐扶刀、口腔CBCT、脉动真空压力蒸汽灭菌器、二氧化碳点阵激光治疗仪
专家论证意见	经审查，洛阳市妇幼保健院辅助生殖、儿童保健专项能力提升项目及危重新生儿诊断救治能力提升项目第五批采购产品一体化阅片中心系统、电子阴道镜、染色体全自动扫描及分析系统、锐扶刀、口腔CBCT、脉动真空压力蒸汽灭菌器、二氧化碳点阵激光治疗仪技术参数设置基本符合国家相关质量技术标准之要求，符合政府采购相关法律法规之要求和规定。
	专家签名：王小庄 2025年11月21日

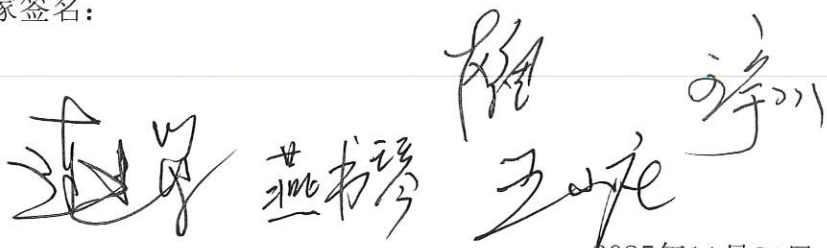
政府采购产品技术参数专家论证意见表

专家姓名	详见论证会专家签到表
工作单位	详见论证会专家签到表
采购单位名称	洛阳市妇幼保健院
项目名称	洛阳市妇幼保健院辅助生殖、儿童保健专项能力提升项目及危重新生儿诊断救治能力提升项目第五批
产品名称	一体化阅片中心系统
专家 论 证 意 见	1、显示器规格建议修改为▲参数。 2、建议删除像素大小参数要求。 3、建议删除要求“提供整机照片及实物照片证明材料”，建议删除要求“提供国家版权局/知识产权局认可的证明材料或提供内置菜单截图”。▲参数要求提供的佐证材料统一描述。 4、建议删除文字性、说明性描述。 5、建议将“四、工作站主机”配置的固态硬盘改为2T固态硬盘。 6、“七、会议音频系统”中的无线麦克风，建议明确数量。 7、“十二、会议办公桌椅一套”中的椅子明确要求（椅背、扶手、面料、是否有滑轮等）。
	专家签名： 燕书珍 刘学军 王峰 李健 2025年11月21日




政府采购产品技术参数专家论证意见表

专家姓名	详见论证会专家签到表
工作单位	详见论证会专家签到表
采购单位名称	洛阳市妇幼保健院
项目名称	洛阳市妇幼保健院辅助生殖、儿童保健专项能力提升项目及危重新生儿诊断救治能力提升项目第五批
产品名称	电子阴道镜
专家 论 证 意 见	1、镜头部分“▲4) 放大倍数”描述建议修改为“显微镜头上至少有7.5倍，15倍，30倍三种固定变倍刻度标识。” 2、镜头部分“6) 观测系统”描述建议修改为“双目收敛观测系统，倾斜角 $\geq 25^{\circ}$ ”。 3、建议删除文字性、说明性描述。 4、▲ 网络连接系统中“机器使用寿命”建议修改为“有效使用年限： ≥ 8 年，需提供设备铭牌照片证明”。
	专家签名： 王书娟 燕书琴 王书娟 2025年11月21日



政府采购产品技术参数专家论证意见表

专家姓名	详见论证会专家签到表
工作单位	详见论证会专家签到表
采购单位名称	洛阳市妇幼保健院
项目名称	洛阳市妇幼保健院辅助生殖、儿童保健专项能力提升项目及危重新生儿诊断救治能力提升项目第五批
产品名称	染色体全自动扫描及分析系统
专家 论 证 意 见	1、全自动扫描设备硬件：“1.成像系统物镜、高倍物镜”描述建议删除，并与“5.▲物镜”参数的描述合并。 2、全自动扫描控制软件：建议删除6.7.8.9条“（需提供第三方检测报告、说明书或其他公开发行的证明材料）”要求，并为加▲项，▲参数要求提供的佐证材料统一描述。 3、全自动扫描控制软件：第26条建议修改为“★”项。 4、“四、产品资质”建议删除，资格条件体现。
	专家签名：  2025年11月21日

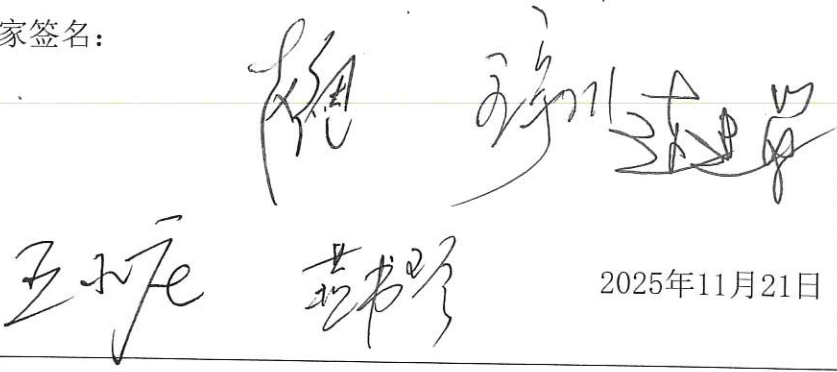
政府采购产品技术参数专家论证意见表

专家姓名	详见论证会专家签到表
工作单位	详见论证会专家签到表
采购单位名称	洛阳市妇幼保健院
项目名称	洛阳市妇幼保健院辅助生殖、儿童保健专项能力提升项目及危重新生儿诊断救治能力提升项目第五批
产品名称	锐扶刀
专 家 论 证 意 见	1、建议修改、完善相关描述。 2、单位、符号统一。 3、建议删除文字性、说明性描述。 4、烟雾收集率建议修改为“95%以上”。
	专家签名：    2025年11月21日



政府采购产品技术参数专家论证意见表

专家姓名	详见论证会专家签到表
工作单位	详见论证会专家签到表
采购单位名称	洛阳市妇幼保健院
项目名称	洛阳市妇幼保健院辅助生殖、儿童保健专项能力提升项目及危重新生儿诊断救治能力提升项目第五批
产品名称	口腔CBCT
专家 论 证 意 见	1、第1条“★”建议修改为“▲”。 2、建议删除文字性、说明性描述。 3、第13.5条建议为“★”，并要求提供承诺函。 4、第14条：“显示器≥23.8英寸”建议修改为“显示器≥23英寸”，“分辨率”建议修改为“分辨率（≥4K，full HD）”。 5、建议修改、完善相关描述。
	专家签名：   2025年11月21日

政府采购产品技术参数专家论证意见表

专家姓名	详见论证会专家签到表
工作单位	详见论证会专家签到表
采购单位名称	洛阳市妇幼保健院
项目名称	洛阳市妇幼保健院辅助生殖、儿童保健专项能力提升项目及危重新生儿诊断救治能力提升项目第五批
产品名称	脉动真空压力蒸汽灭菌器
专家 论 证 意 见	1、“1.容积”建议修改为“★”项。 2、“2.密封门”建议修改为“▲”项；“设计温度≥148℃”建议修改为“工作温度≥144℃”。 3、建议删除“提供证明材料”要求，▲参数要求提供的佐证材料统一描述。 4、第26条建议为“★”项，并提供承诺函。 5、建议删除文字性、说明性描述。
	专家签名：  2025年11月21日

政府采购产品技术参数专家论证意见表

专家姓名	详见论证会专家签到表
工作单位	详见论证会专家签到表
采购单位名称	洛阳市妇幼保健院
项目名称	洛阳市妇幼保健院辅助生殖、儿童保健专项能力提升项目及危重新生儿诊断救治能力提升项目第五批
产品名称	二氧化碳点阵激光治疗仪
专 家 论 证 意 见	1、第1条建议修改为“▲”项。 2、第21条“光斑范围：10*10mm”建议修改为“光斑范围：≥10*10mm”。 3、建议删除文字性、说明性描述，合并相关描述。
	专家签名：      2025年11月21日