

新郑市公立人民医院 40 排 CT 球管采购项目

单一来源采购协商情况记录

一、采购项目名称：新郑市公立人民医院 40 排 CT 球管采购项目

二、计划编号：新财单一采购-2025-1

三、依据《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十八条进行公示的，公示情况说明：

本项目于 2025 年 03 月 14 日在河南省政府采购网、郑州市政府采购网、新郑市政府采购网（<https://xinzheng.zfcg.henan.gov.cn/xinzheng>）进行单一来源采购征求意见公示，公示期限：2025 年 03 月 14 日至 2025 年 03 月 21 日，公示期间无任何供应商提出异议。

四、本项目采购计划于 2025 年 6 月 26 日报财政部门备案。

五、协商日期、协商地点、采购全体人员名单

1. 协商日期：2025 年 07 月 17 日

2. 协商地点：新郑市公共资源交易中心

3. 采购全体人员名单：

供应商代表：河南允诺医疗器械有限公司

采购人代表：付豪

经济、技术专家：李长新 刘洁

六、供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明：

1. 初始报价：

河南允诺医疗器械有限公司：529500.00 元

2. 同类项目合同价格：无

3. 相关专利、专有技术等情况或明：无

七、价格商定情况

1. 第二轮报价：

河南允诺医疗器械有限公司：529000.00 元

2. 根据供应商的二次报价，成交结果如下：

成交单位：河南允诺医疗器械有限公司

付豪

刘洁

成交金额：529000.00 元

供货（含安装调试）期：7 日历天

质量要求：符合国家及行业标准，满足采购人要求

八、合同主要条款：

1. 合同总价人民币：529000.00 元，大写：伍拾贰万玖仟元整
2. 供货（含安装调试）期：7 日历天
3. 质量要求：符合国家及行业标准，满足采购人要求

采购全体人员签字：

供应商代表签字：

李强强

采购人代表签字：

刘洁

协商小组人员签字：

张斌 刘洁

2025 年 07 月 17 日

附件：第 二 轮报价表（最后报价）

（此表不装订入响应文件，只需在协商中填写，无需在响应文件中填写）

项目名称	新郑市公立人民医院 40 排 CT 球管采购项目
供 应 商	河南允诺医疗器械有限公司
投标内容	新郑市公立人民医院 40 排 CT 球管
第二轮 投标报价（元）	（大写） 伍拾贰万玖仟元整 （小写） ￥529000.00
交货地点	采购人指定地点
供货 （含安装调试）期	7日历天
质量要求	符合国家及行业标准，满足采购人要求
投标有效期	90日历天（投标截止之日起）
备注	



供应商（盖单位公章）：河南允诺医疗器械有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：李强

日期：2025.7.17

五、技术性能参数的详细描述

序号	名称	品牌型号	详细技术参数
1	X射线球管组件	上海联影 CTR 2150CEUH	球管热容量 5.3MHU 阳极靶面直径190mm 球管阳极最大散热率815kHU/min 小焦点尺寸0.5mm×1.0mm 大焦点尺寸1.0mm×1.0mm 最小管电压70kV 最大管电压140kV 管电压档位70kV, 80kV, 100kV, 120kV, 140kV 最小管电流10mA 最大管电流420mA 最小灯丝频率50 Hz 最大灯丝频率40 kHz 球管灯丝最大瞬时电流5.2A



注：后附采购需求要求的相关资料。

(一)、产品整机注册证



中华人民共和国医疗器械注册证


注册证编号：国械注准20173061504

注册人名称	上海联影医疗科技股份有限公司
注册人住所	上海市嘉定区城北路2258号
生产地址	上海市嘉定区城北路2258号
代理人名称	/
代理人住所	/
产品名称	X射线计算机体层摄影设备
型号、规格	uCT 530
结构及组成	产品由X射线球管组件，X射线球管，高压发生器，探测器，检查床，扫描架，计算机，显示器，CT控制盒，限束器，电源柜，系统软件，附件及软件选件组成。附件及软件选件详见产品技术要求。
适用范围	对从多方向穿过X射线信息进行计算机处理，为诊断提供重建影像。
附 件	产品技术要求
其他内容	/
备 注	延续注册产品技术要求未发生变化，沿用原核发的产品技术要求。原注册证编号：国械注准20173061504

审批部门：



批准日期：二〇二二年四月一日
生效日期：二〇二二年十一月十四日
有效期至：二〇二七年十一月十三日

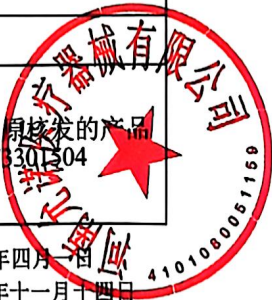

(二)、产品整机配置

医疗器械产品技术要求编号：

X 射线计算机体层摄影设备

1. 产品型号

1.1 产品型号命名

本产品规格型号：uCT 530；

uCT：CT 商品名；

530：表示具体产品代号。



1.2 产品配置

部件名称/临床功能	部件型号	规格参数	型号 uCT 530
X 射线球管组件	CTR2150 CEUH	靶角：7° 最大峰值管电压：140 kV 峰值电压档位：70, 80, 100, 120, 140 kV 阳极最大热容量：5.3 MHU 焦点尺寸： 小焦点 0.5 mm x 1.0 mm 大焦点 1.0 mm x 1.0 mm	√
X 射线球管	DU 5008H	N.A	√
高压发生器	CT70PN50X 4429	最大功率：50 kW 高压范围：60 kV~140 kV.(bipolar.30 to 70 KV)	√
探测器	U40 CT DMS	探测器材料：固态稀土陶瓷 探测器像素：34560 探测器物理排数：40 排 探测器覆盖范围：22mm	√
检查床	80100042	最大承载重量 205kg	
扫描架	U40 Gantry	机架孔径：700mm 倾斜角度：±30° 机架最高旋转速度：0.5s	



第 1 页/ 共 27 页

(三)、球管性能参数

上海联影医疗科技股份有限公司
Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.
嘉定 Tel: +86 (21) 67076888 Fax: +86 (21) 67076889
张江 Tel: +86 (21) 20305888 Fax: +86 (21) 20305889
深圳 Tel: +86 (755) 26808523 Fax: +86 (755) 26808525
www.united-imaging.com/

UNITED 联影
IMAGING

uCT 530球管参数

性能参数:

项目	具体参数
型号	CTR 2150CEUH
球管热容量	5.3MHU
阳极靶面直径	190 mm
球管阳极最大散热率	815kHU/min
小焦点尺寸	0.5mm x 1.0mm
大焦点尺寸	1.0mm * 1.0mm
最小管电压	70kV
最大管电压	140kV
管电压档位	70kV,80kV,100kV,120kV,140kV
最小管电流	10mA
最大管电流	420mA
最小灯丝频率	50 Hz
最大灯丝频率	40 kHz
球管灯丝最大瞬时电流	5.2A



(四)、工程师名单及认证

河南省内本地 CT 专职工程师人员清单及证书

姓名	从业时间
许钰楠	2017 年 9 月-至今
李子文	2015 年 3 月-至今
王梓	2019 年 3 月-至今



证书编号: UIHCT201801049.

产品培训证书

特此授予

许钰楠

于2017年8月22日至2017年9月8日期间在上海完成了

uCT Basic Training

产品型号: uCT510/uCT760/uCT520/uCT530/uCT790/uCT960.



许钰楠

客户关系管理部副總裁


日期: 2017年9月8日



联影客户服务中心

日期: 2017年9月8日

UNITED 联影
IMAGING

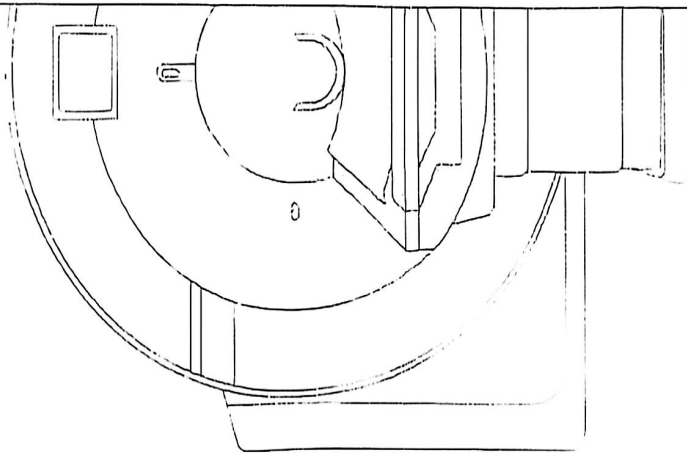

证书编号: UIH-CT-201903020

产品培训证书

特此授予


李子文

于2019年3月18日至2019年3月22日期间在上海联影客户服务培训中心完成了

CT Basic Training

产品系列: CT 系列

课程主要内容: 安全培训/系统功能/系统应用/预防保养/维修保养

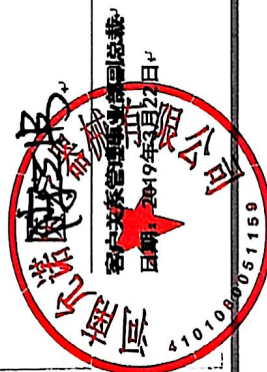

证书编号: UIH-CT-201903028

产品培训证书

特此授予

王梓

于2019年3月18日至2019年3月22日期间在上海联影客户服务培训中心完成了

CT Basic Training

产品系列: CT 系列

课程主要内容: 安全培训/系统功能/系统应用/预防保养/维修保养

陈立伟

客户关系管理事业部副总裁

日期: 2019年3月22日

联影客户服务培训中心

日期: 2019年3月22日



六、技术规格偏差表

序号	投标货物技术条款	技术参数及要求		对采购文件偏差	备注
		招标书	投标书		
1	球管热容量	$\geq 5.3\text{MHU}$	5.3MHU	无偏差	
2	阳极靶面直径	$\geq 190\text{mm}$	190mm	无偏差	
3	球管阳极最大散热率	$\geq 815\text{kHU/min}$	815kHU/min	无偏差	
4	小焦点尺寸	$\geq 0.5\text{mm} \times 1.0\text{mm}$	$0.5\text{mm} \times 1.0\text{mm}$	无偏差	
5	大焦点尺寸	$\leq 1.0\text{mm} \times 1.0\text{mm}$	$1.0\text{mm} \times 1.0\text{mm}$	无偏差	
6	最小管电压	70kV	70kV	无偏差	
7	最大管电压	140kV	140kV	无偏差	
8	管电压档位	70kV, 80kV, 100kV, 120kV, 140kV	70kV, 80kV, 100kV, 120kV, 140kV	无偏差	
9	最小管电流	$\geq 10\text{mA}$	10mA	无偏差	
10	最大管电流	$\geq 420\text{mA}$	420mA	无偏差	
11	最小灯丝频率	50 Hz	50 Hz	无偏差	
12	最大灯丝频率	40 kHz	40 kHz	无偏差	
13	球管灯丝最大瞬时电流	$\geq 5.2\text{A}$	5.2A	无偏差	
14		所更换的球管必须为原厂原装全新球管。保证来源合法且可追溯	所更换的球管为原厂原装全新球管。来源合法且可追溯	无偏差	



15		供应商具有在有效期内的 CT 原厂维修资质证书, 且至少有 3 名全职的、CT 原厂认证合格的工程师 (提供证书)	具有在有效期内的 CT 原厂维修资质证书, 且有 3 名全职的、CT 原厂认证合格的工程师	无偏差	详见标书 74 页
16		供应商必须及时免费提供全套完整的系统改版升级服务	免费提供全套完整的系统改版升级服务	无偏差	
17	球管保修期	不少于一年或 20 万秒次, 以先到为准	一年或 20 万秒次, 以先到为准	无偏差	
18		所投 CT 球管须与现有 CT 设备 (品牌: 联影, 型号: UCT530) 完全适配, 且符合联影 UCT530 型 CT 整机注册要求; 若因 CT 球管不适配造成 CT 设备损坏, 由供应商承担全部责任。	所投 CT 球管与现有 CT 设备 (品牌: 联影, 型号: UCT530) 完全适配, 且符合联影 UCT530 型 CT 整机注册要求	无偏差	详见标书 71, 72 页



注明: 1、投标货物存在偏差的必须如实填写本表。

2、表格不足时供应商可根据需要另行添加。

3、偏差项必须按照投标货物的符合度，如实填写，无偏差、正偏差、负偏差。（偏差情况不得填无、正或负）

供应商（盖单位公章）：河南允诺医疗器械有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：李强强

日期：2025年07月15日

